

設備機器の配置変更案について

主な配置変更等

試料作製室

- ・スリッパ
室外に設置。
- ・中央の実験台
1台に減らして、部屋全体のスペースを広くする。
- ・HistraQS
有機溶媒と超音波が室内へ影響しないよう個室(作製室)へ。
- ・ウルトラマイクローム
 - 2台とも同じ個室に設置
 - 1台を個室、もう1台は個室の外に設置
 - 1台の運用を終了する など検討中
- ・滑走式マイクローム
流し台の近くに設置。
- ・その他
各切片作製装置の近くに正立顕微鏡を設置予定。


電子顕微鏡室2

- ・JEM-1220
修理不可のため、解体して廃棄の予定。
新しい共焦点レーザー顕微鏡の設置場所として利用予定。

光学顕微鏡室

- ・LSM510
修理不可のため、廃棄の予定。
- ・その他
各装置周辺のスペースを広く確保できるように配置変更予定。

現在の配置

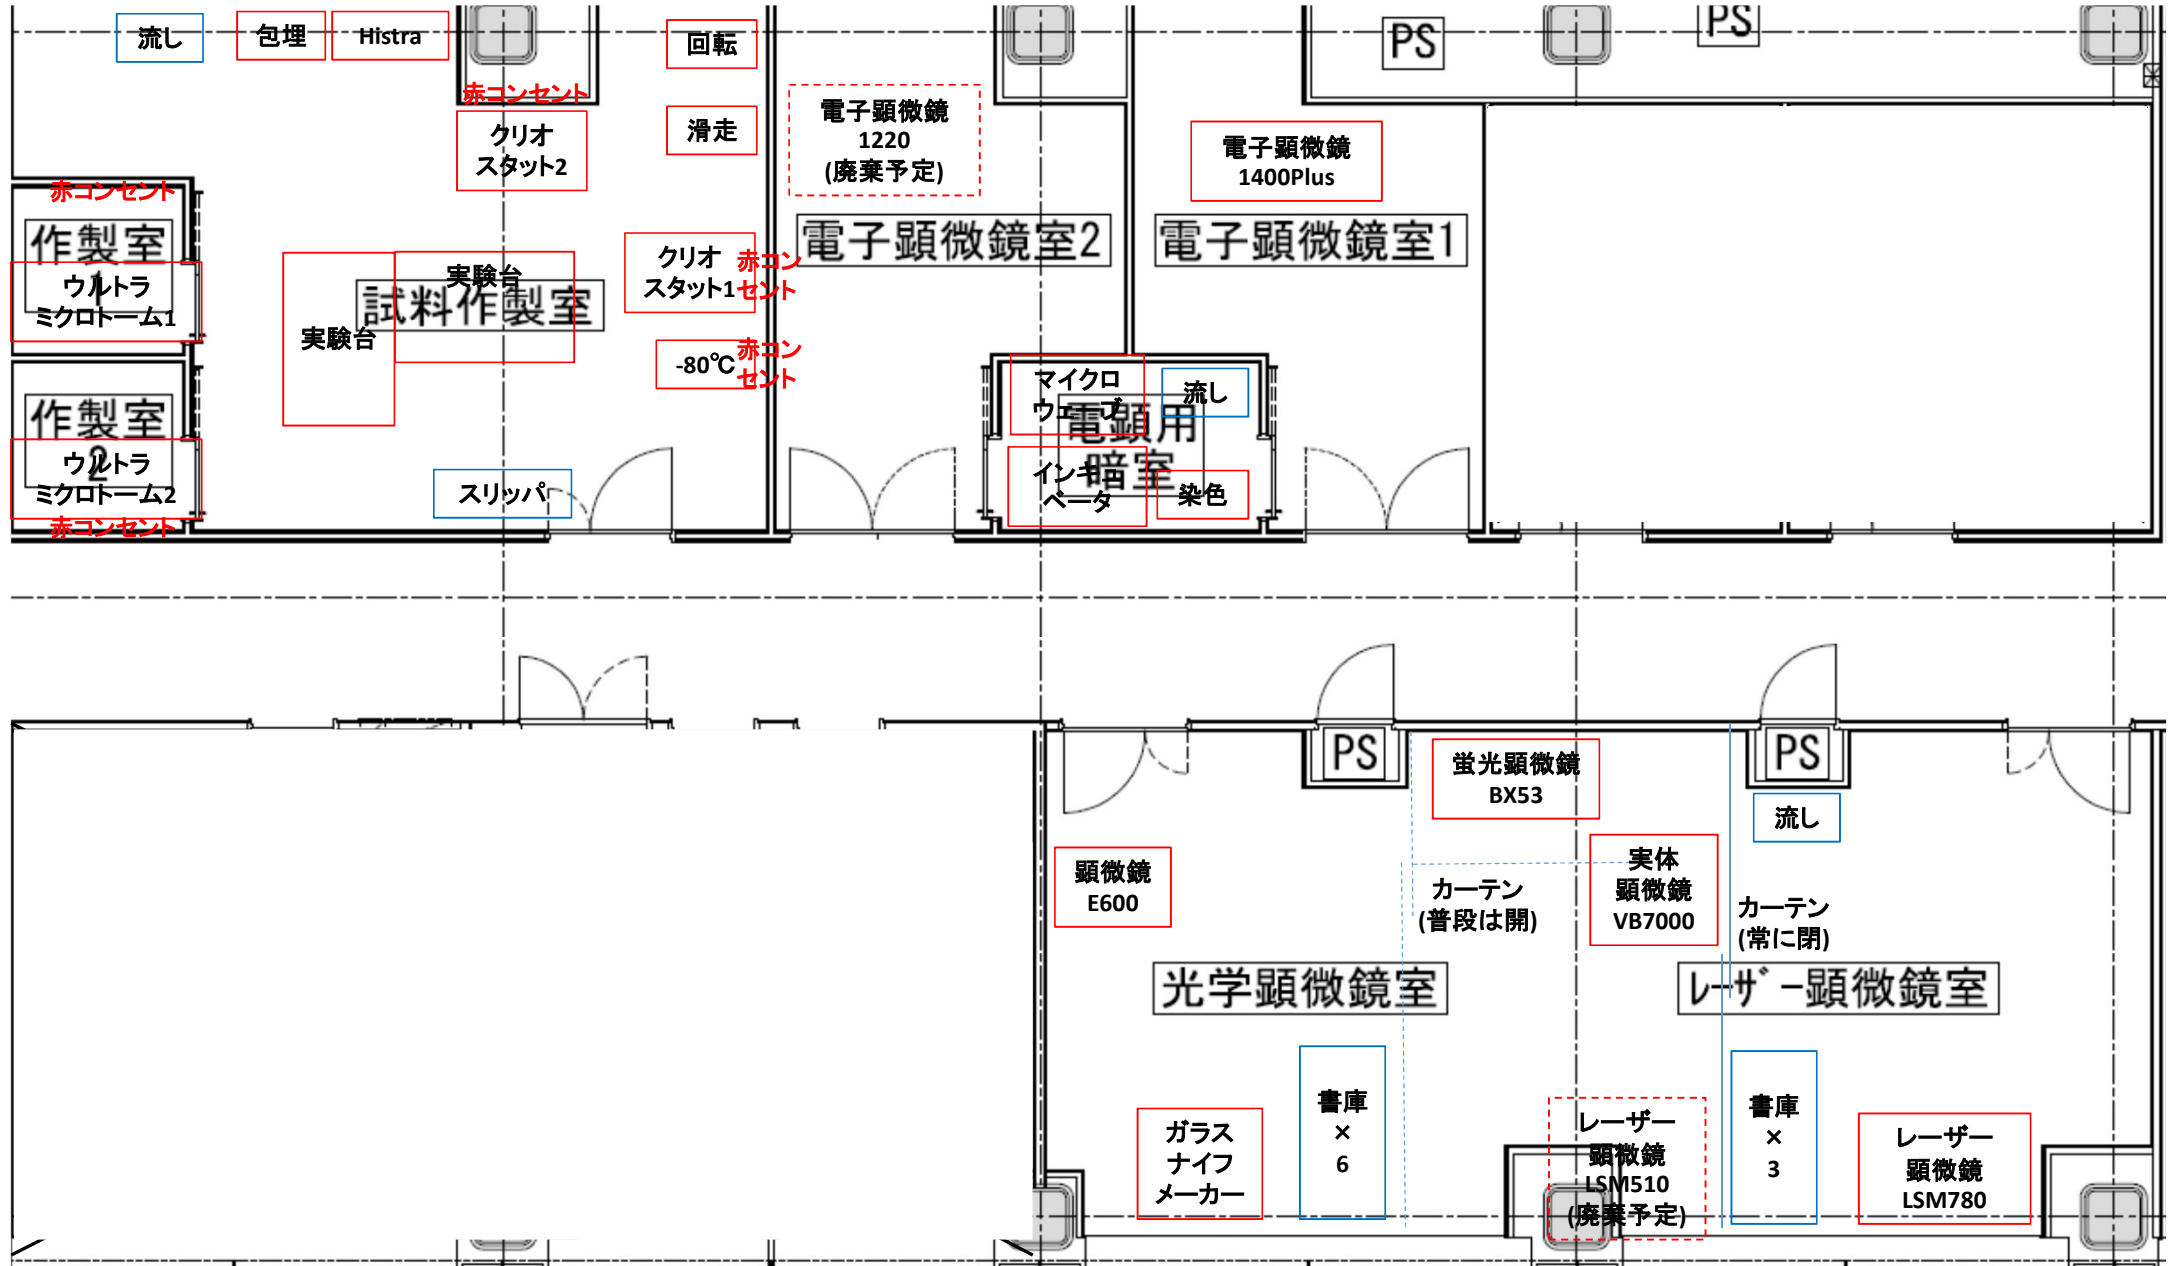

配置変更案

